radwag.com

Stanowisko do kalibracji pipet SDKP DUAL

WL-101-0173

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,E9O



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.


Dane techniczne


Parametry fizyczne	
Elementy zestawu	Stół do wzorcowania, stół antywibracyjny ×2, sondy pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, sonda pomiaru temperatury wody, zlew na zużytą ciecz, zbiornik na zużytą ciecz, monitor LCD, komputer PC, pompka do odsysania cieczy, program PIPETY Radwag, klawiatura i mysz, podłokietniki
Wymiary opakowania osłony	820×1410×1000 mm
Masa brutto	250 kg
Długość	1350 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	1100 mm
Liczba stanowisk	2


Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga analityczna AS X7
Końcówki do pipet
Waga analityczna AS 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych


Wymiary urządzenia S x G x W

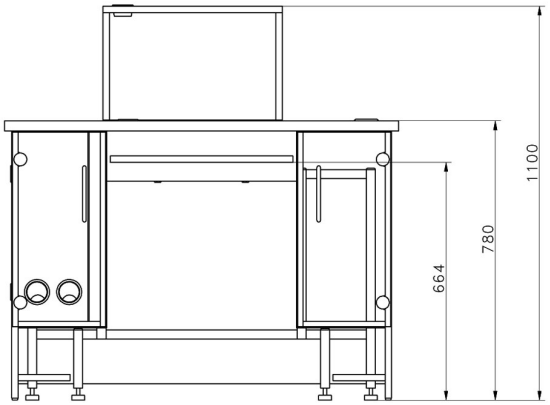

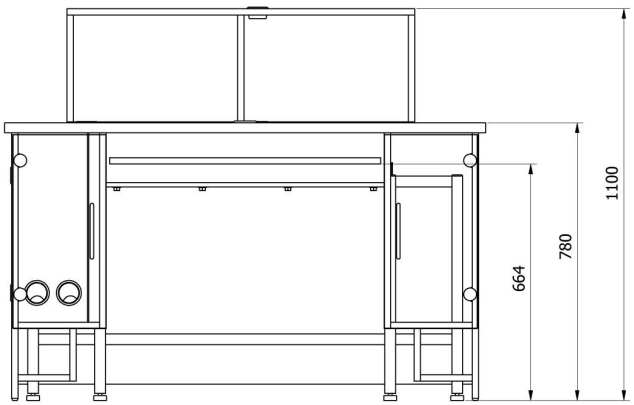

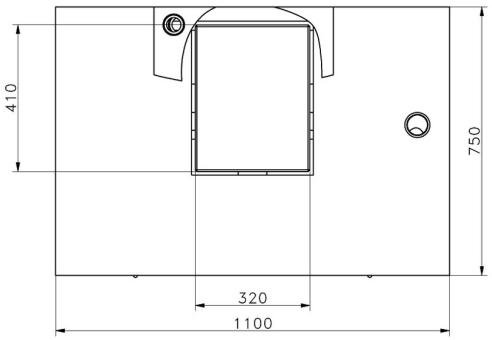

SDKP

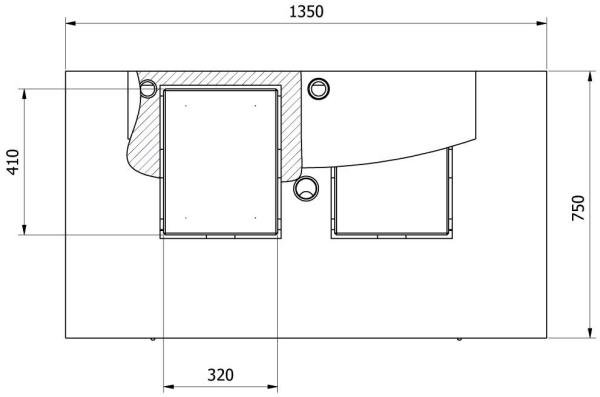

SDKP DUAL