radwag.com

XA11 - XA.5Y.M.A用 ピペット校正アダプタ 11 ml

WX-001-0462

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,KEK

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

□□

XA11 ピペット校正アダプターは、XA.M.A ミクロ天秤を使用した重力法によるピストンピペットの校正および検証を可能にします。

セット内容:

ベース 計量皿 計量容器 蒸発防止リング 分注用開口部付きガラスチャンバー

蒸発防止リングはアダプターの一部として組み込まれており、計量チャンバー内の相対湿度を高めます。これにより、校正や検証の際に液体の蒸発を防ぎ、精確な測定を実現します。
計量皿は容器を チャンバーの中心に安定して配置 できる設計になっており、精度の高い計量をサポートします。 計量皿と容器は ガラスチャンバー内に配置されており、液体を投与できる開口部を備えています。この設計により、外部の気流を最小限に抑え、安定した計量環境を提供します。

容器容量: 11 ml

ピペット校正用アダプター

ピペット校正用アダプターは、重力法 を用いたピストンピペットの校正および検証を目的としています。このアダプターを使用することで、計量容器の質量分 天秤の最大ひょう量が低下します。以下の表では、ISO 8655-6:2022 規格 に基づく最小要件を示しており、適切なピペット校正アダプターと対応する天びんのバージョンを選択できます。また、天秤のパラメータは、測定時の拡張不確かさが試験対象の最大許容誤差の ¼ 未満

23-02-2025 1/2 radwag.com

[illegible]

[a] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]2[illegible] [illegible]
[c] [illegible]
[d] [illegible] [illegible]0.01 mg[illegible] 20 µl [illegible] [illegible] [illegible] ¼ [illegible]
[e] [illegible] 2 µl [illegible] [illegible] [illegible] ¼ [illegible]

[illegible] (Additional Fee)

XA 5Y.M.A [illegible]

[illegible]

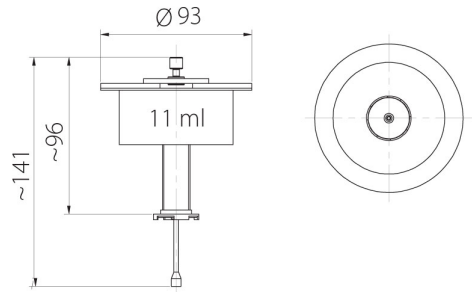

MY11

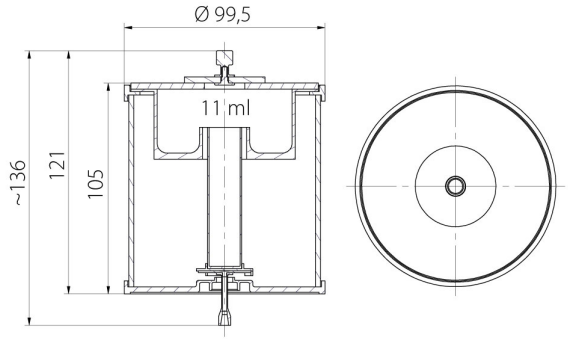

XA11

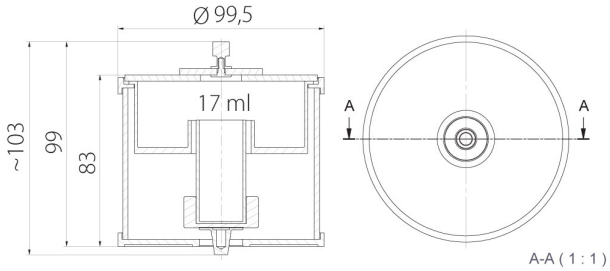

XA17

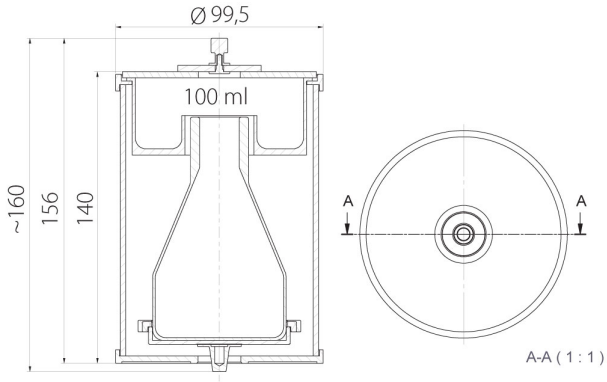

XA100