




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Q01

Fingerabdruck-Leser

WX-006-0048

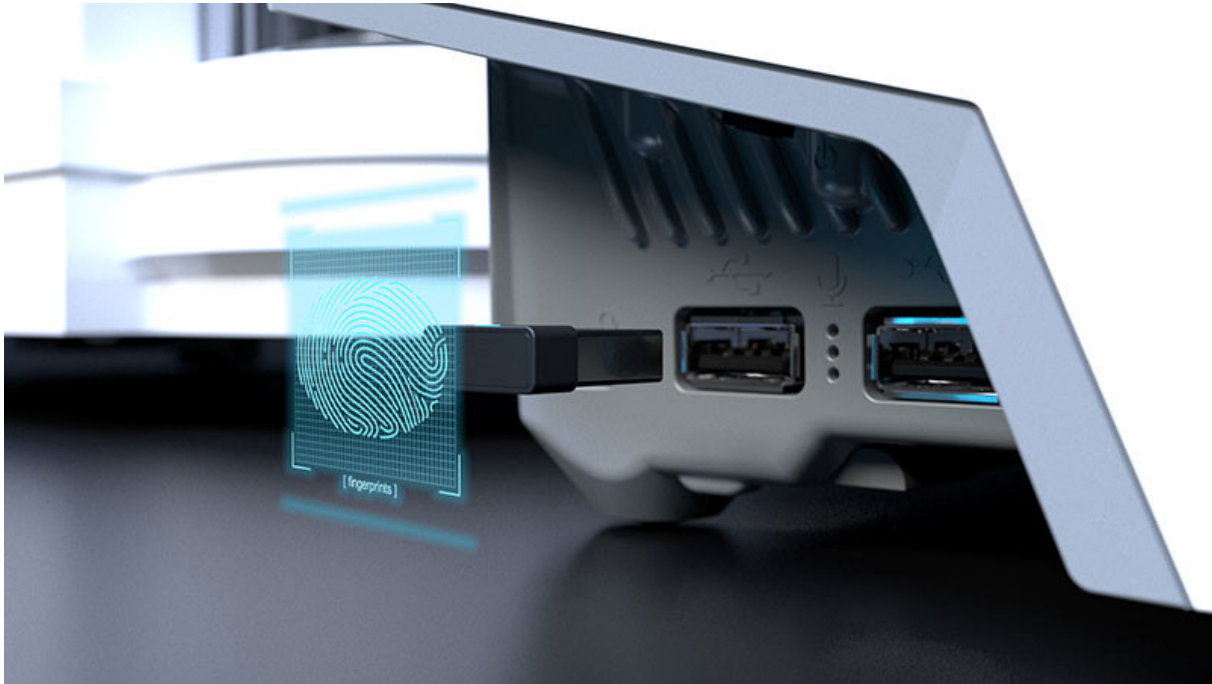

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Ein Zubehörteil für die ELLIPSIS-Laborwaagen, das zum Einlesen von Fingerabdrücken dient, um sich an der Waage anzumelden. Berühren Sie einfach das Lesegerät, um sich einzuloggen. Der Fingerabdruckleser wird über den USB-Anschluss an die ELLIPSIS-Waage angeschlossen.



Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents
 UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Waagen CY10 für FPVO

Automatische Massekomparator UMA
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
 Robotische Massekomparatoren
 Dichte-Massekomparatoren
 Mikrowaage MYA 5Y
 Analysenwaage XA 5Y
 Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO

Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Analysenwaage XA 5Y.A
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Präzisionswaage PS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
Mikrowaage XA 5Y.M
RMC F Roboter-Wägesystem
RB F Roboter-Wägesystem
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem