
radwag.com

Lector de huellas dactilares

WX-006-0048

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QO1

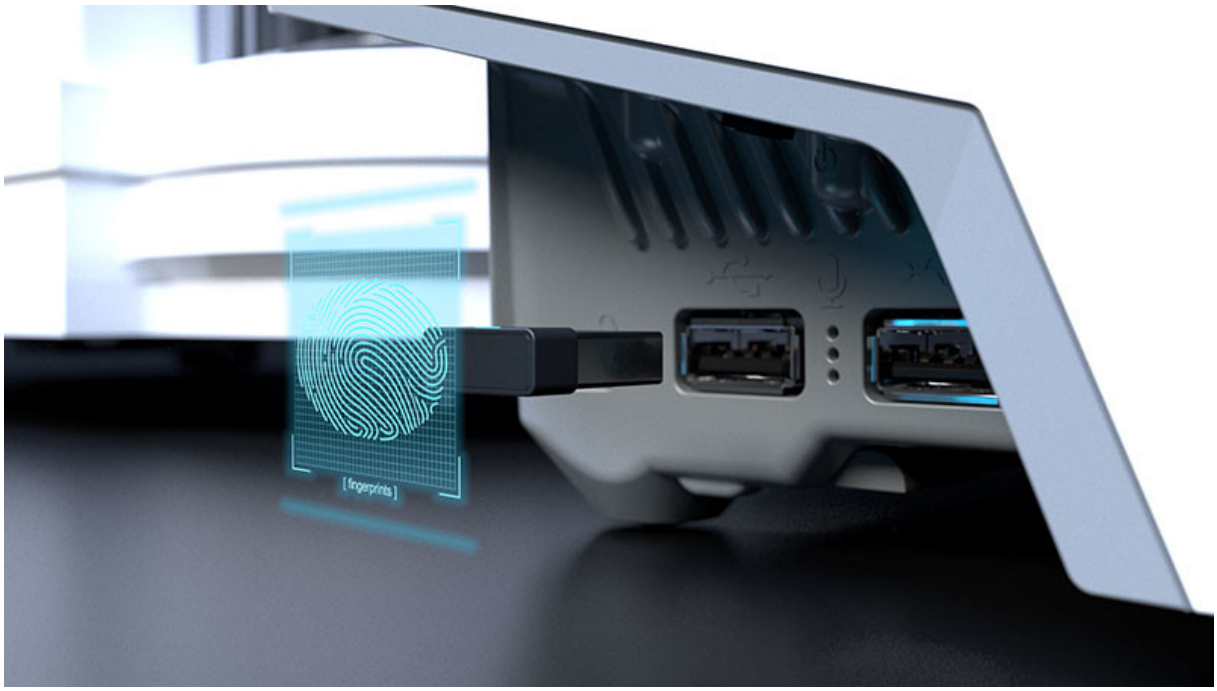

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Accesorio para balanzas de laboratorio de la serie ELLIPSIS, destinado a la lectura de huellas dactilares para iniciar sesión en la balanza. Para iniciar sesión en la balanza, simplemente toque el lector. El lector de huellas dactilares se conecta a la balanza ELLIPSIS a través del puerto USB.

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Balanza automática para stents AK-5/100 STENT
Sistemas de pesaje automáticos UMA 5Y.F
Analizador de HumedadMA 5Y
Balanza de precisión 5Y.PM
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Comparador de masa automático UMA
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
Comparadores de masa robóticos
Comparadores para la medición de densidad
Microbalanza MYA 5Y

Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanzas CY10 para CCE
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
Balanza analítica XA 5Y.A
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Ultramicrobalanza UYA 5Y
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Balanza de precisión PS 5Y
Balanzas PS 5Y para CCE
Comparador de masa automático AKM-2
Balanza de precisión CY10
Balanza analítica XA 5Y
Susceptómetros manuales - Magnetismo
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO
Comparadores de masa automáticos al vacío
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Susceptómetros automáticos - Magnetismo
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB
Microbalanza XA 5Y.M
Sistemas de pesaje robótico RMC F
Sistemas de pesaje robótico RB F
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Ultramicrobalanza para filtros UYA 5Y.F
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Sistemas de pesaje automáticos AK-6 5Y.F