




## Czytnik linii papilarnych

WX-006-0048

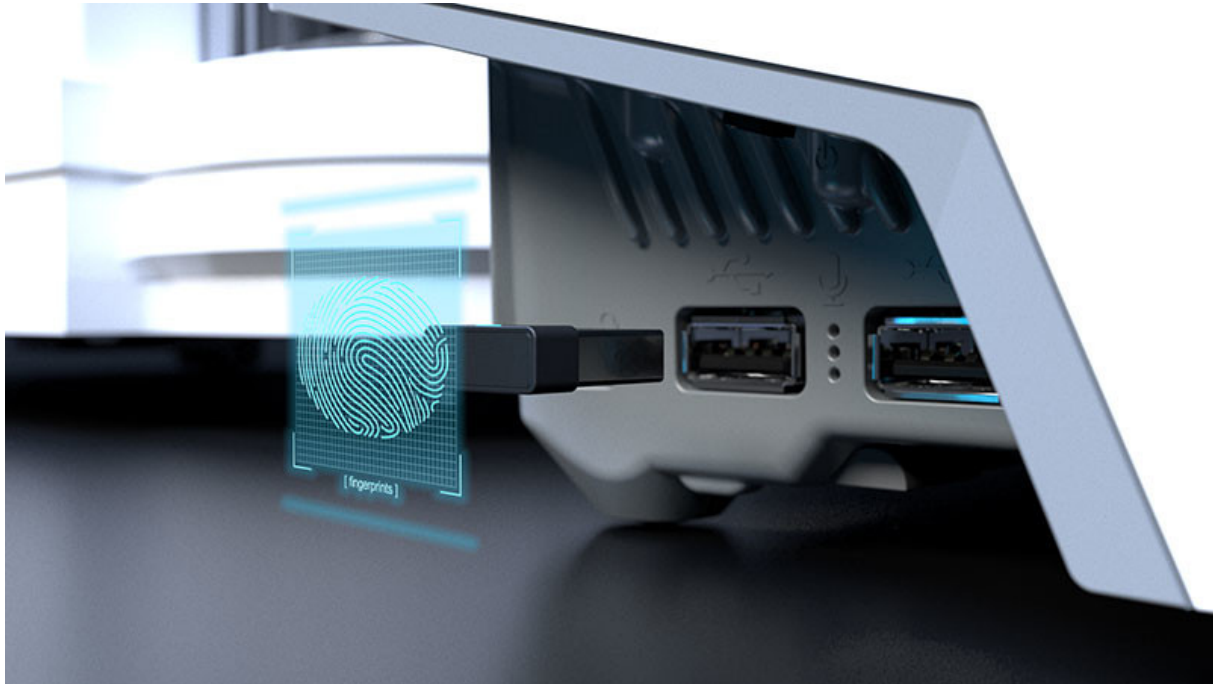

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Akcesorium do wagi laboratoryjnej serii ELLIPSIS przeznaczone do skanowania linii papilarnych w celu zalogowania się do wagi. Aby zalogować się do wagi, wystarczy dotknąć czytnika. Czytnik linii papilarnych jest podłączany do wagi ELLIPSIS za pośrednictwem portu USB.



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT  
 Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Waga precyzyjna 5Y.PM  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Mikrowaga XA 5Y.M.A  
 Wagi CY10 do KTP

Automatyczny komparator masy UMA  
 Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
 Robotyczne komparatory masy  
 Komparatory do pomiaru gęstości  
 Mikrowaga MYA 5Y  
 Waga analityczna XA 5Y  
 Manualne susceptometry do pomiaru magnetyzmu  
 Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
 Manualny komparator masy HRP 5Y.KO

Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Waga analityczna AS 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Automatyczne susceptometry do pomiaru magnetyzmu  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Robotyczny System Wagowy RMC F  
Robotyczny System Wagowy RB F  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F